
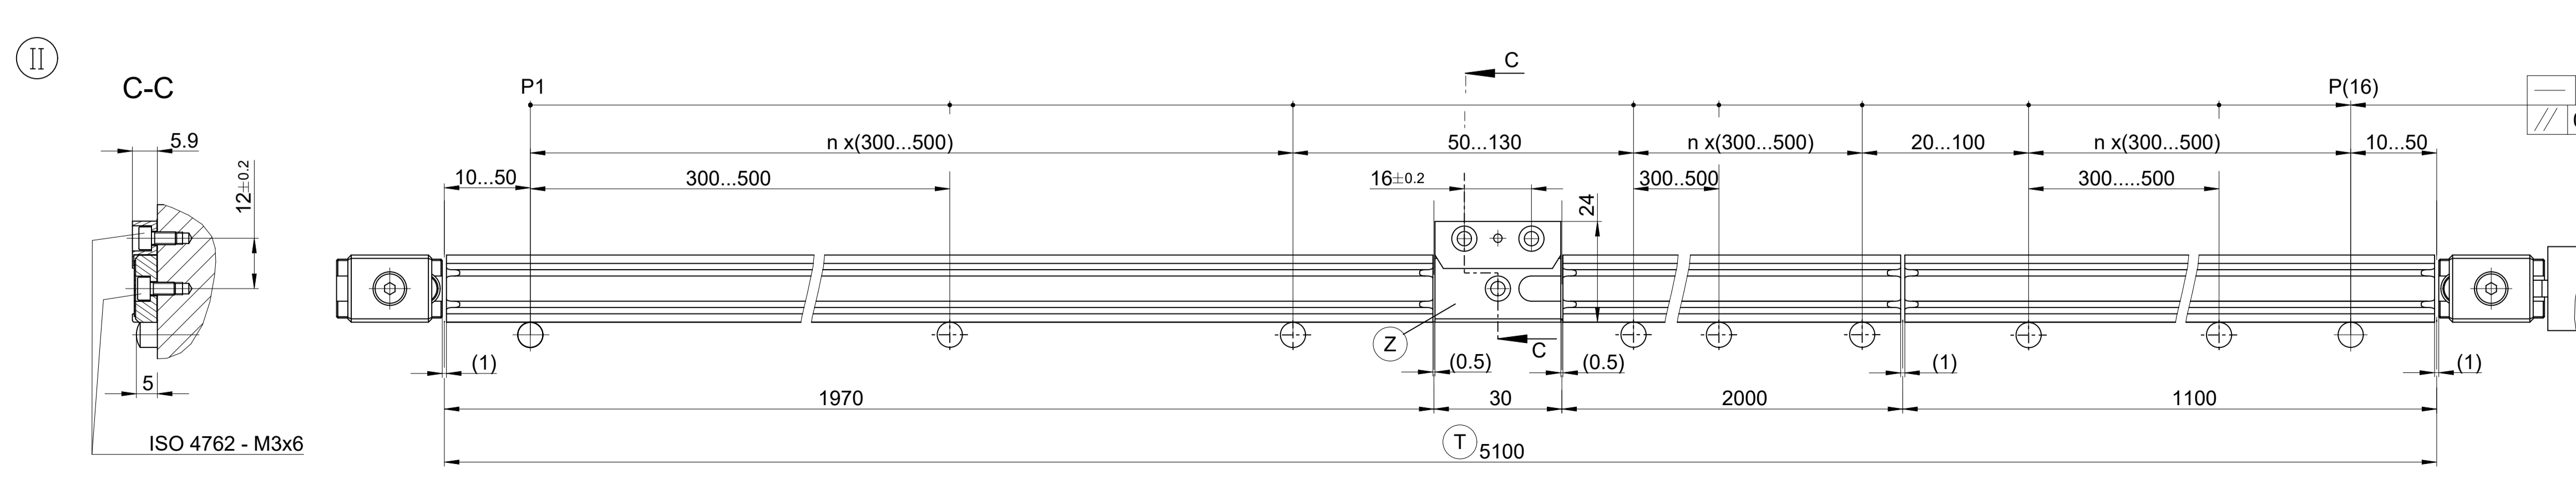


	d	R	R
		Feste Verlegung Rigid configuration	Wechselbiegung Frequent flexing
PUR	D 3.7 mm	> 8 mm	>= 40 mm
PUR	D 2.9 mm	> 6 mm	>= 30 mm

ML	Z
≤ 3040	0x
≤ 5040	1x
≤ 7040	2x
•	•
•	•
≤ 30040	14x

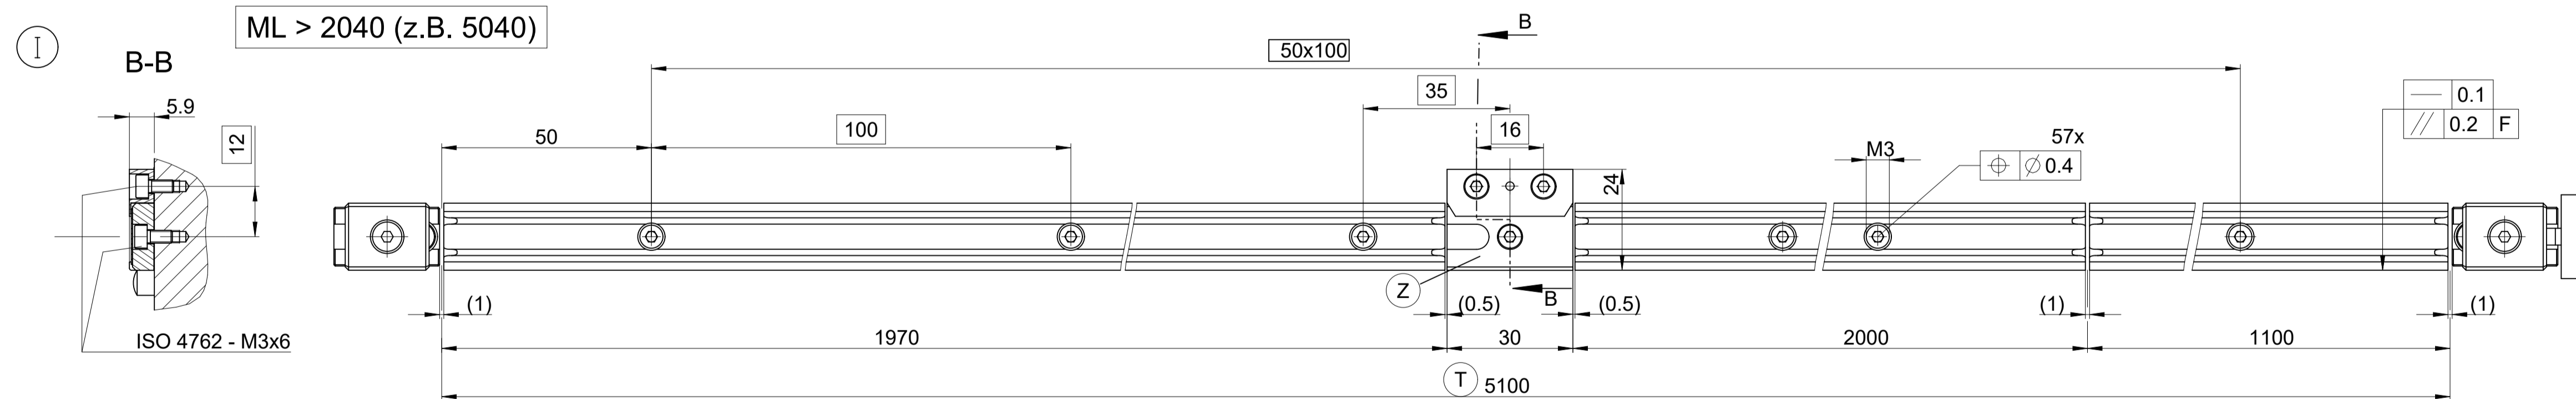

- I = Maßbandträger-Teilstücke geschraubt Carrier selections bolted
- II = Maßbandträger-Teilstücke mit PRECIMET geklebt Carrier selections fastend with PRECIMET
- I II III = Montagemöglichkeiten Mounting options
- F = Maschinenführung Machine guideway
- * = Anbaufehler plus dyn. - Fühungsfehler Mounting failure plus dyn. failures-of guideway
- p = Messpunkte zum Ausrichten Gauging points for alignment
- S = Beginn der Messlänge ML Beginning of measuring length ML
- T = Träger Länge Carrier length
- Z = Zwischenstück ab Messlänge > 3040mm Spacer required as of measuring length > 3040mm
- H1 = Optische Mittellinie Optical centreline
- H2 = Montageabstand Abtastkopf zu Profil Mounting gap
- H3 = Bewegungsrichtung der Abtasteinheit für Ausgangssignale gemäß Schnittstellenbeschreibung Direction of scanning unit motion for output signals in accordance with interface description

ID number: C160627-05		Change No. Serie	
Original drawing Scale Format		LIC 41x5 LIC 41x5	
Dimensions in mm 1:1 A1		Anschlussmaße / Mating Dimensions	
Tolerances as per ISO 8015		General Tolerances ISO 2768-1:2008-mH 56mm:±0.2	
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design. (ISO 18015)		Released 15.12.2023	
HEIDENHAIN DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH 83301 Traunreut, Germany		Version Revision Sheet Page D 825359-06-A-01 1 of 1	